

RELATÓRIO TÉCNICO PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº 002/2024. Edital Retificado

De acordo com o edital,

A empresa **GC LAB DIAGNOSTICOS**, apresentou proposta de fornecer os itens no intervalo de 1 a 27, onde, de acordo com o termo de referência, **1.1.3. Os Subitens 1 a 27 foram agrupados em um único item devido a necessidade de padronização dos produtos em apenas uma marca/laboratório, independente da marca/laboratório, considerando a importância da homogeneidade dos produtos utilizados nos procedimentos feitos pelos técnicos e constância e segurança nos resultados de testes. Assim, a licitante deverá ofertar para todos os subitens do item 1 a mesma marca/laboratório.**


A proposta enviada pela GC LAB DIAGNÓSTICOS entre os itens acima citados, contém duas marcas diferentes, que são: VIDA e KATAL, sendo 25 itens da marca VIDA e 2 itens da marca KATAL, dados esses verificados na proposta enviada pela mesma, e para que se cumpra o edital, a mesma fica impossibilitada de fornecer os reagentes descritos desses subitens, pelo motivo que já consta no edital.

Ainda para fins de andamento desse processo, favor solicitar ao fornecedor que apresentou a melhor proposta, que nos envie as amostras dos itens/reagentes para que possamos fazer os testes necessários de acordo com o edital e tabela abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO
1	FERRITINA TURBIDIMETRIA
2	CREATININA
3	ÁCIDO ÚRICO
4	KIT ALT/GPT
5	KIT AST/GOT
6	KIT REAGENTE BIOQUÍMICA BILIRRUBINAS TOTAL E DIRETA PARA APARELHO BIOPLUS
7	COLESTEROL
8	FOSFATASE ALCALINA
9	GAMA GT
10	GLICOSE
11	LACTATO
12	CKMB
13	CK-NAC
14	REAGENTE PCR QUANTITATIVO TURBIDIMETRIA
15	TRIGLICÉRIDES LÍQUIDO
16	URÉIA LIQUIDA
17	PADRÃO DE BILIRRUBINAS COMPATIVEL COM O REAGENTE DE BILIRRUBINAS

18	BILIRRUBINA DIRETA
19	BILIRRUBINA TOTAL
20	AMILASE
21	REAGENTE CONTROLE PCR QUANTITATIVO
22	CALIBRADOR PCR TURBIDIMETRIA
23	HDL
24	LDH UV
25	CALIBRADOR
26	SORO CONTROLE NORMAL E PATOLOGICO
27	SORO CONTROLE FERRITINA

Ouvidor, 11 de abril de 2024

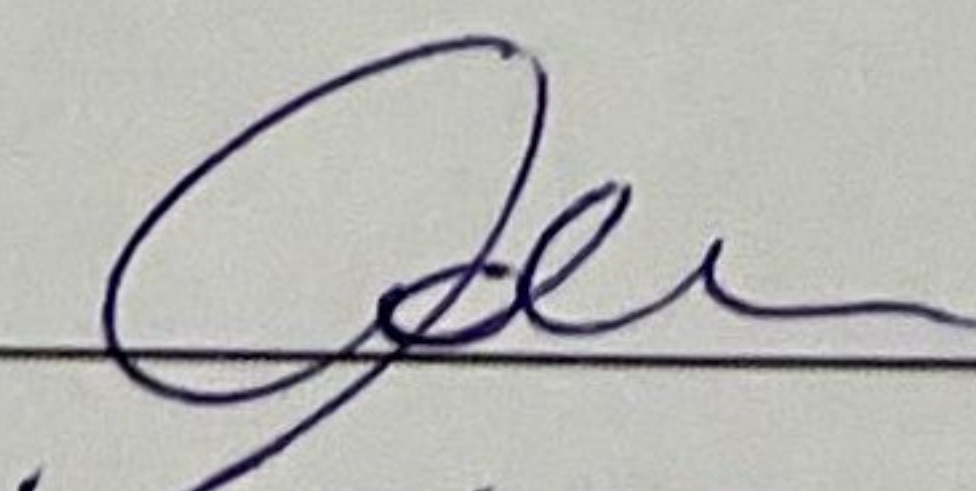

ANDRÉ MARCELINO PIRES
BIOMÉDICO - RESPONSÁVEL TÉCNICO
LABORATÓRIO MUNICIPAL